



## Konfiguration/Configuration

## Benutzer/Operator

Intervall/Interval 00:05:00  
 Start möglich durch/Start possible by Taste/Button  
 Startverzögerung/Start delay 00:00:00  
 Stopp möglich durch/Stop possible by USB Verbindung/USB connect

## Temperatur/Temperature

Feuchtigkeit/Humidity  
 Alarmverzögerung/Alarm delay

Alarm unten/Alarm low

-40.0 °C

0.0 %rH

00:00:00

Alarm oben/Alarm high

70.0 °C

100.0 %rH

## Zusammenfassung/Summary

## Startzeit/Start time

14.08.2015 14:11:09

## Start durch/Start by

Taste/Button

## Stoppzeit/Stop time

14.08.2015 16:56:09

## Stopp durch/Stop by

USB Verbindung/USB connect

## Datensätze/Records

34

## Dauer/Duration

02:45:00

## Temperatur/Temperature

Min 28.2 °C

Avg 28.6 °C

Max 31.3 °C

## Feuchtigkeit/Humidity

41.9 %rH

45.1 %rH

47.4 %rH

## Taupunkt/Dew point

15.1 °C


15.4 °C

16.8 °C

## Alarm/Alarm

Anzahl/Count

0

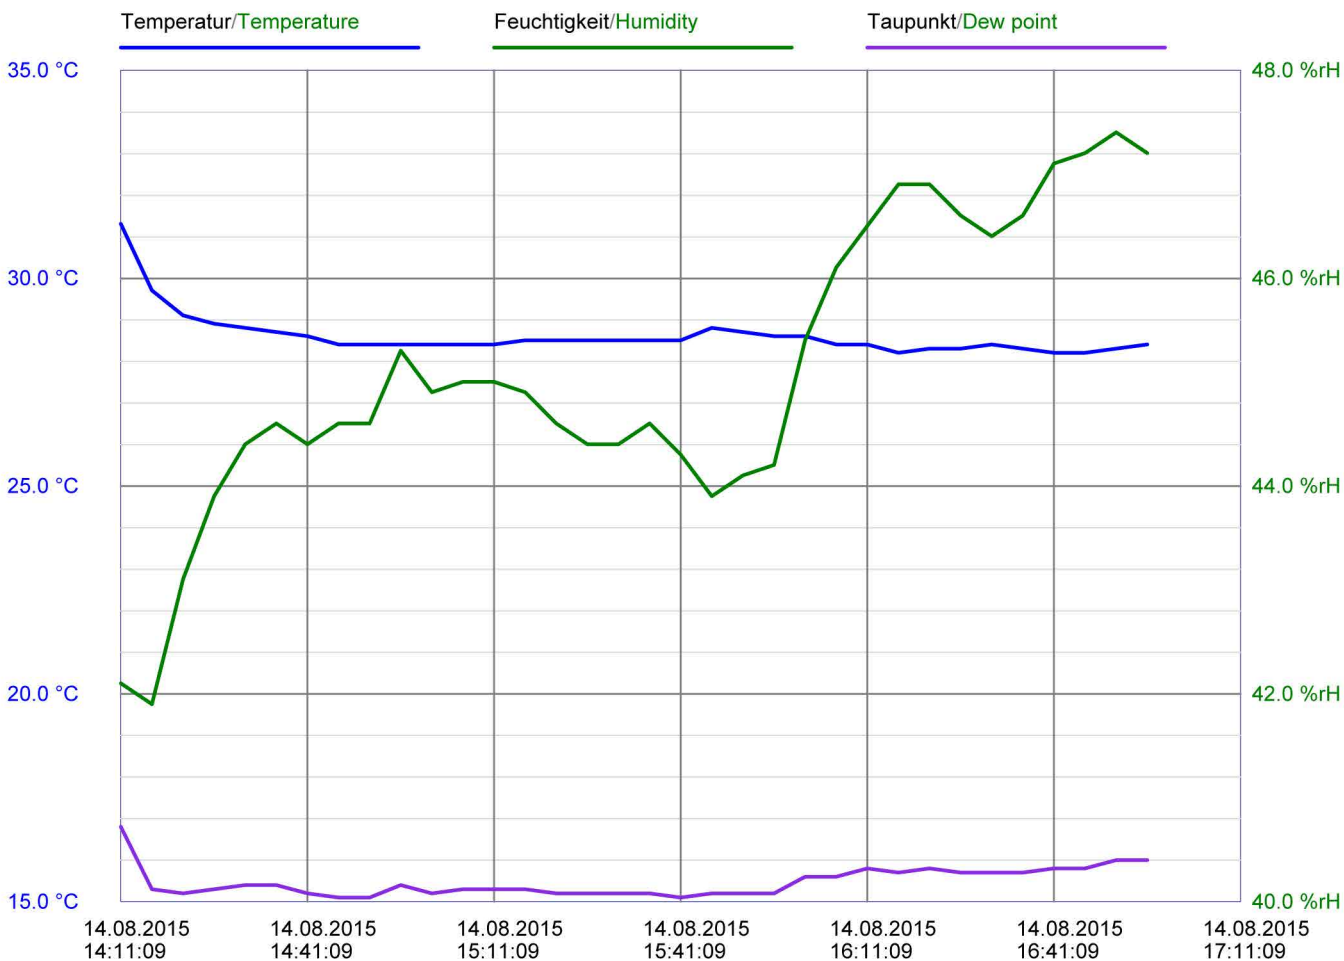

Unterschrift/Signature